



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告
TEST REPORT

报告编号	KZ20200164
样品名称	布口罩 (SPDF001)
委托单位	东莞市心朋实业有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



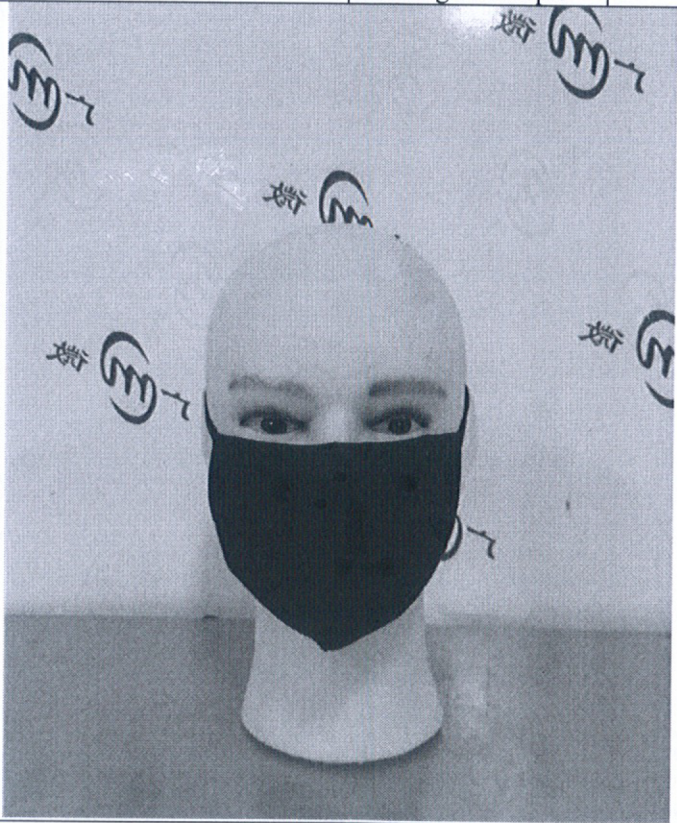
检测编号: KZ20200164
Test No.

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告
TEST REPORT

收样日期: 2020 年 04 月 20 日
Date Received

检测日期: 2020 年 04 月 27 日
Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	布口罩 (SPDF001)	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	东莞市心朋实业有限公司	样品来源 Source of Sample	委托方送检
生产单位 Manufacturer	——	商标 Brand	——
型号规格 Type and Specification	——	样品数量 Quantity of Sample	1 份 (28 个)
生产日期 Date of Production	——	样品描述 Sample Description	片状
生产批号 Batch Number	——	样品包装 Packing of Sample	袋装
样品图片 Sample Picture			
检验依据和方法 Standard and Methods	GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器		
检测项目 Items of Analysis	1. 过滤效率 2. 呼气阻力 3. 吸气阻力		
备注 Remarks	——		

接下页/To be continued



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



检测编号: KZ20200164
Test No.

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告
TEST REPORT

收样日期: 2020 年 04 月 20 日
Date Received

检测日期: 2020 年 04 月 27 日
Date Analyzed

检测结果
Test Results

序号 Serial	检测项目 Test Items	单位 Unit	检测结果 Results	标准要求 Requirement
1	过滤效率 (氯化钠)	%	90.3	KN90 ($\geq 90.0\%$); KN95 ($\geq 95.0\%$); KN100 ($\geq 99.97\%$).
2	呼气阻力	Pa	54.2	≤ 250
3	吸气阻力	Pa	68.0	≤ 350

报告结束/End of report

编制:
Editor

盛嘉俊

审核:
Checker

徐国祥

签发:
Issuer

王明

签发日期 (公章):
Date Reported





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019001121

声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖检测单位“检验检测专用章”无效，无相关责任人签名无效，复印件无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本单位不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。
- 四、 本检测报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、 报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“#”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“+”为只通过广东省资质认定的项目。
- 六、 报告中未取得广东省资质认定的项目，检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 七、 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址：（与联系地址不同时填写此项）

邮政编码：510663

联系电话：（8620）61302671

网址：<http://www.ggtest.com.cn>